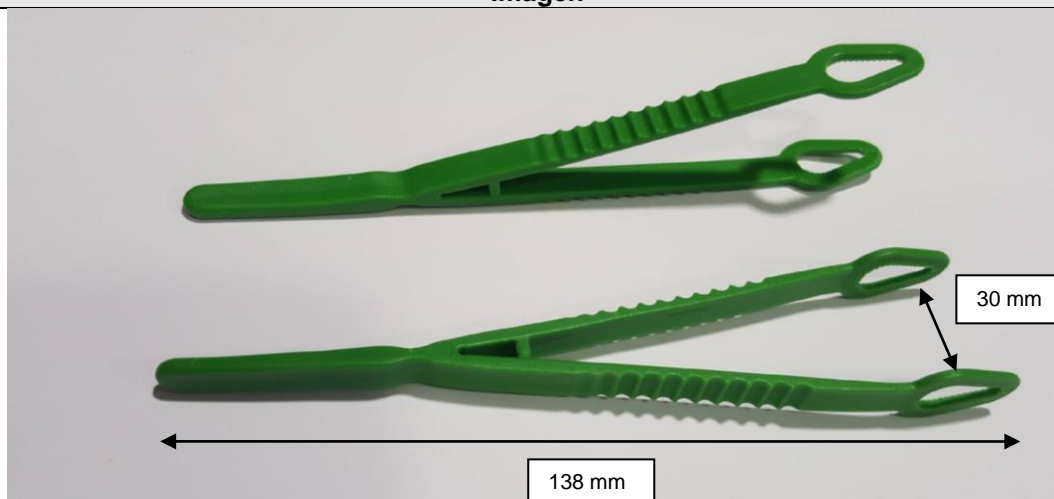


**FICHA TÉCNICA**
**Código**
**Descripción**
**AC 175L V (138 mm.)**
**Pinza anatómica – verde**

**Imagen**


**Dispositivo médico de clase I no estéril certificado de acuerdo con el Reglamento de la EU 2017/745 (MDR) según el anexo II+III.**

Fabricado en Nylon reforzado con un 30% de fibra de vidrio y 20% de talco.

Dispositivo que se utiliza para sujetar gasas y tampones durante las operaciones generales de vendaje.

Sin látex

No contiene ftalatos

**Control de calidad:** visual

**Esterilizable** con: Óxido de Etileno; Rayos Gamma – Beta (hasta 25kGy)

**Envase** estándar: 1000 piezas sueltas, no estériles, en doble bolsa de polietileno y cartón.

**Conservación:** Conservar los productos sanitarios en un ambiente seco y limpio, lejado de fuentes directas de calor.

**Temperatura de almacenamiento:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Vida útil del producto:** 7 años

**Atención:** La exposición de este artículo a materiales, productos químicos, modos de esterilización o temperaturas distintos de los especificados puede causar cambios en el material del producto.

Si el uso es distinto, el comprador será el único responsable de la elección, adecuación y uso de este producto.

**Registro:** Código AC 175-CND V9099-GMDN-N° Publicación RDM 2206066